www.ema.es

CE

DIRECTIVAS BAJA TENSIÓN Y EMC

Manuel d'utilisation

pour la réalisation de traitements

MN-8000

Mise en marche

de l'appareil

www.ema.es

MN-8000

Manuel d'utilisation

pour la réalisation de traitements

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LISEZ LES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION. GARDEZ CE MANUEL POUR LES FUTURES CONSULTATIONS.

La MN 8000 est une méthode professionnel de chauffage par sudation. Cet appareil doit être exclusivement utilisé pour l'usage auquel il est destiné.

Quand vous recevez la marchandise, assurez-vous qu'elle n'a pas subit de dommages et que tous les composants sont arrivés complets et en bon état. Si vous avez des doutes, n'utilisez pas l'appareil et vérifiez si les dommages peuvent être dus à une mauvaise manipulation durant le transport. Dans ce cas, contactez votre distributeur dans les 24 heures après la réception afin que le transporteur se responsabilise de la qualité du produit.

Avant de connecter l'appareil, vérifiez si les données indiquées sur l'étiquette de l'appareil correspondent aux caractéristiques du réseau électrique. Il n'est pas possible de changer la tension d'alimentation de l'appareil. Si la tension n'est pas correcte, contactez votre distributeur et n'essayez pas de brancher l'appareil.

L'appareil en fonctionnement demande la présence continue de personnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MN 8000 est formée par:

- Un appareil de commande central (unité de contrôle.).
- Un sac divisé en trois zones indépendantes.
- 3 sections internes de thermo chauffage amovibles.
- Un câble d'alimentation.
- Un coussin pour le confort du client.

Optionnel:

- *Masque faciale de thermo chauffage.*

Unité de contrôle:

- Alimentation primaire : 230V
- Alimentation secondaire : 24V
- 50 Hz
- Courant alternant ~
- Appareil de Classe II

Sac divisé en trois zones indépendantes:

Matériel: 25% polyester – 25% expansion
50% polyuréthane / vinyle

Dimensions: Fermée env. 2.000 x 700 mm
Ouverte env. 2.000 x 1.600 m

CE

DIRECTIVES BASSE TENSIÓN ET EMC

Couverture thermo chauffante amovible de 24V:

Matériel: Intérieur 100% polyester
Extérieur 100% vinyle

Dimensions: env. 1.500 x 580 mm
24 V ~ 50 Hz 100 W

Réglage continu de la température à travers un senseur inséré dans la résistance.

Ce produit a été fabriqué en conformité avec les standards de la CE : 89/336/CEE (Compatibilité électromagnétique), 73/23/CEE (Basse tension, sécurité électrique).

UNITÉ DE CONTRÔLE

DESCRIPTION DES COMMANDES (FRONTAL)

1. Démarrage
2. Stop
3. Augmentation de la température dans les zones corporelles indiquées :
   - Extrémités inférieures.
   - Hanches et abdomen.
   - Poitrine.
4. Diminution de la température dans les zones corporelles indiquées :
   - Extrémités inférieures.
   - Hanches et abdomen.
   - Poitrine.
5. Sélection des programmes enregistrés sur l'appareil.
6. Augmentation du temps (minutes).
7. Diminution du temps (minutes).
8. Reset (clear).

DESCRIPTION DES COMMANDES (ARRIÈRE):

9. Connecteurs pour les sections thermo chauffantes corporelles (sous-section intérieure, moyenne et supérieure).
10. Bouton pour brancher et éteindre.
11. Prise de réseau.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES SUR LE DISPLAY

SYMBOLE	SITUATION	SIGNIFICATION
↵	Première ligne du display	FLÈCHE : STAND BY
≡≡	Première ligne du display	DEUX COLONNES DE PETITES LIGNES : MAINTENANCE: La MN-8000 reste chaude à une température d'env. 30ºC
🧍	Première ligne du display	FIGURE DE L'USAGER : Traitement du corps commencé
!	Dernière ligne du display	POINT D'EXCLAMATION : Pause pour modifier la programmation du temps et de la température
▶	Dernière ligne du display	TRIANGLE REMPLI : Visualisation du niveau de température programmé
□	Dernière ligne du display	CARRÉ VIDE CLIGNOTANT : niveau de température que l'on va obtenir
■	Dernière ligne du display	CARRÉ REMPLI FIXE : niveau de température programmé obtenu
—	Dernière ligne du display	LIGNE : Le niveau de température programmé est zéro. NE CHAUFFE PAS.

INSTALLATION

L'installation doit être faite selon les instructions données ci-dessous. Une erreur d'installation peut causer des dommages à des personnes, des animaux ou des objets, pour lesquels le fabricant ne peut pas être tenu responsable.

L'installation demande la connection suivante entre les différentes parties de l'appareil:

1. Mettez la MN-8000 sur la table comme indiqué dans Fig. 1.
2. Connectez les 3 sous-sections thermo chauffantes corporelles (9) à l'équipe de travail.
3. Connectez le câble d'alimentation à l'équipe de travail (11) et la prise de courant.

Quand les opérations décrites ont été faites, la couverture sac MN-8000 est prête pour l'utilisation.

Fig. 1

PRE-FONCTIONNEMENT

1. Mettez l'appareil en marche en mettant l'interrupteur général en position ON (10). L'écran ci-dessous apparaîtra à partir duquel il est possible de faire toutes les programmations.

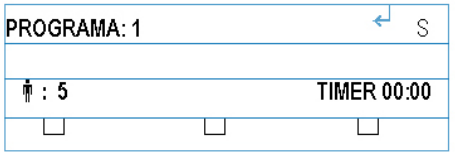

2. Appuyez sur le bouton START (1) une fois. Après 3 minutes environ, l'appareil entre en état de MAINTENANCE (Puissance minimum, seulement un curseur programmé).

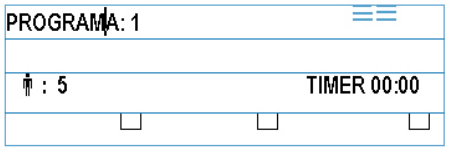

N.B. L'état de MAINTENANCE est indiqué par l'icône (≡ ≡), qui apparaîtra en première ligne au lieu de l'icône (↵) S.

INSTALLATION

PRE-FONCTIONNEMENT

NB: Durant cette phase, la température atteint 30ºC et elle se maintient à ce niveau tout au long de la journée. Ce système permet de disposer d'un appareil toujours préparé permettant de commencer un nouveau traitement à n'importe quel moment. Durant l'état de maintenance, la consommation d'énergie diminue en moyenne de 100W durant la phase d'utilisation à 18W par sous-section thermo chauffante, ce qui suppose une économie d'énergie considérable.

NOTES

FONCTIONNEMENT

1. Sélection de programme

L'appareil prévoit la possibilité de choisir entre 10 programmes (entre 0 et 9). Ces programmes peuvent être reconfigurés librement, que ce soit au niveau de la durée du traitement ou au niveau de la température.

La sélection du programme commence en appuyant plusieurs fois sur le bouton PROG (5). Quand vous avez sélectionné le programme de votre choix, vous pouvez procéder à la personnalisation (temps et température), comme décrit ensuite.

2. Programmation du niveau de puissance (température).

Une fois sélectionné le programme de votre choix, il est possible de continuer avec la programmation du niveau de puissance.

Pour chacune des sous-sections thermo chauffantes il faut sélectionner le niveau de température de votre choix (Min. 0 Max. 5) à l'aide des boutons +/- (3/4) situés sur le display. En appuyant sur ces boutons, les curseurs (■) de la quatrième ligne du display disparaîtront et des flèches (▶) apparaîtront. Une fois programmé le niveau de température de chaque sous-section thermo chauffante, les curseurs (■) apparaîtront de nouveau à la place des flèches (▶).

Les flèches indiquent le niveau de puissance programmé. Durant le traitement il est à chaque moment possible de contrôler le niveau de puissance antérieurement sélectionné en appuyant sur les boutons +/- (3/4).

Il est possible d'exclure une ou plusieurs sous-sections thermo chauffantes du traitement en appuyant plusieurs fois sur les boutons de diminution correspondants (4) jusqu'à ce qu'un tiret apparaisse(—).

FONCTIONNEMENT

Sélectionnez le niveau de température:

(—): Température de la couverture inactive (sans chauffer).

(▶): Niveau 1. Minimum (MAINTENANCE ou Mode d'attente).

(▶ ▶): Niveau 2.

(▶ ▶ ▶): Niveau 3.

(▶ ▶ ▶ ▶): Niveau 4.

(▶ ▶ ▶ ▶ ▶): Niveau 5. Maximum.

3. Programmation du Timer:

CORPOREL: La programmation du temps se fait en appuyant sur les boutons de temps (6) et (7). Le timer peut être programmé pour une durée maximum de 60 minutes.

FONCTIONNEMENT

INDICATIONS

4. Début du traitement :

Après avoir introduit tous les paramètres, le traitement commence en appuyant sur le bouton de commencement (1). Le timer, qui reflète le temps en minutes et secondes, commencera son décompte, en montrant le temps qui reste jusqu'à la fin du traitement.

Une fois le temps programmé écoulé, un signal acoustique vous avisera que le temps de traitement est terminé. La MN-8000 se déconnectera automatiquement, en retournant au mode de maintenance de température, préparée pour commencer un nouveau traitement.

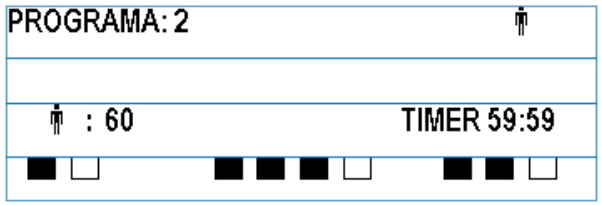

Indications des niveaux de température durant le traitement

Grâce aux indications visibles sur le display, vous disposez toujours d'information sur le niveau de puissance et, par conséquence, la température de chaque secteur. Le curseur 'rempli' stable (■) indique que le niveau de choix a été obtenu. Le curseur 'vide' clignotant (▸) indique que le niveau de température programmé est en cours d'être obtenu.

A la fin de chaque session, l'appareil adoptera AUTOMATIQUEMENT la température de MAINTENANCE équivalent au premier niveau.

Visualisation/modification/interruption du traitement

Durant le traitement, il est possible de VISUALISER la programmation réalisée antérieurement, en appuyant sur les boutons +/- (3/4).

Si vous avez besoin de MODIFIER LES PARAMÈTRES (température- temps), appuyez sur le bouton STOP (2). Sur la première ligne du display, un point d'exclamation (!) apparaîtra au lieu de l'icône de traitement (■). Modifiez la température à l'aide du bouton +/- (3/4) et le temps à l'aide du bouton (6/7). Pour recommencer le traitement, appuyez sur le bouton START (1).

INDICATIONS

Si, au contraire, vous aimeriez INTERROMPRE le traitement de façon DÉFINITIVE, il suffit d'appuyer sur le bouton CLEAR (8). Les icônes de traitement disparaîtront automatiquement, le timer se mettra à zéro et l'appareil entrera en mode de MAINTENANCE.

Signalisation d'alarme

L'appareil peut détecter n'importe quel défaut dans les sections de traitement, qu'il s'agisse d'un stop, d'un court-circuit ou d'un manque d'alimentation. S'il se produit un de ces cas, une alarme acoustique s'activera afin d'avertir où se trouve le problème et un écran d'alarme apparaîtra sur le display indiquant quelle est la section thermique défectueuse.

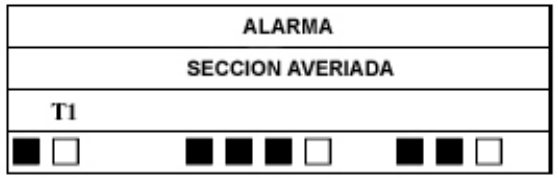

Afin de sortir de l'écran d'alarme, appuyez sur le bouton CLEAR (8). Quand le menu principal apparaît de nouveau, il est déjà possible de remplacer la section thermique défectueuse (appuyez sur le bouton de diminution de température de cette sortie jusqu'à ce que le tiret apparaisse). Appuyez sur INICIO (DÉBUT) (1) afin de reprendre le traitement.

PROGRAMMES

Les programmes de la MN 8000 permettent une sélection plus personnalisée et multiple des options de traitement. Elles seront détaillées par la suite dans un tableau. Dans ce tableau on a détaillé également des paramètres, tels que le type de traitement, la durée, la température obtenue, le symbole utilisé sur l'écran d'identification de traitement, etc.

Identification des programmes:

Le programme **1** est l'état de **MAINTENANCE**. Il s'agit d'un programme de transition qui permet d'avoir un appareil préparé durant toute la journée.

Le programme **2** est un programme TONNIFIANT corporel (**RELAXATION**)de durée moyenne. Durant 30 minutes, ce programme augmente la température du corps de façon agréable.

Le programme **3** est un programme TONNIFIANT corporel (**RELAXATION**) de courte durée. Indiqué en tant que préparation pour d'autres traitements comme l'électro stimulation.

Le programme **4** est un programme **DE SUDATION INTENSE de longue durée** pour le corps entier. On recommande de l'utiliser avec des produits lypolitiques comme des argiles et des algues afin de favoriser la destruction des graisses localisées.

Le programme **5** est un programme de **SUDATION INTENSE de courte durée** pour le corps complet. On recommande son utilisation pour le traitement d'adiposités dans des zones spécifiques. C'est la version réduite du programme 4, idéale pour des personnes qui ne veulent pas plus de 20 minutes de traitement.

Le programme **6** est un programme de **SUDATION MODÉRÉE** de **courte** durée, pour les personnes ayant une tolérance à la chaleur inférieure aux températures obtenues avec les programmes 4 et 5.

Le programme **7** est un programme de **SUDATION INTENSE de longue durée**, qui concentre l'action de la température externe sur les zones de l'ABDOMEN et la POITRINE.

Le programme **8** est un programme de **SUDATION INTENSE de courte durée**, qui concentre l'action de la température externe sur les zones de l'ABDOMEN et la POITRINE.

Le programme **9** est un programme de **SUDATION MODÉRÉE de longue durée,** pour les personnes ayant des problèmes au niveau de l'ABDOMEN et des CUISSES.

Le programme **0** est un programme de **SUDATION MODÉRÉE de courte durée,** pour les personnes dont le problème esthétique se situe sur l'ABDOMEN.

Au moment où se termine le temps programmé, la MN-8000 ne s'éteint pas, mais entre automatiquement en phase de 'MAINTENANCE', c'est-à-dire, le programme n°1 (env. 30°). Ce système permet de disposer d'un appareil toujours prêt pour faire un nouveau traitement.

MN-8000

Manuel d'utilisation

pour la réalisation de traitements

**Température testée avec température environnementale d'env. 20°C.*

Prog.	Traitement	Temps(min).	Température*	Symbole	Indication graphique de la température de chaque sous-section: Corps inférieur, moyen et supérieur			Traitement
1	STAND BY (EN ATTENTE)	5	30°	≡≡	■	■	■	MODE HOLD (MAINTENANCE)
2	CORPOREL	30	37°		■■	■■	■■	TONNIFIANT 1
3	CORPOREL	20	35°		■■	■■	■■	TONNIFIANT 2
4	CORPOREL	40	58°		■■■■■	■■■■	■■■■■	CORPS COMPLET 1 Long
5	CORPOREL	30	58°		■■■■■	■■■■	■■■■■	CORPS COMPLET 2 Court
6	CORPOREL	30	47°		■■■	■■■	■■■	CORPS COMPLET 3 Court Light
7	CORPOREL	40	52°		■■■	■■■■■	■■■■	ABDOMEN/ POITRINE 1 Long
8	CORPOREL	30	52°		■■■	■■■■■	■■■■	ABDOMEN/ POITRINE 2 Court
9	CORPOREL	30	50°		■■■■	■■■■■	■■■	ABDOMEN/ JAMBES
0	CORPOREL	20	43°		■■	■■■■	■■	ABDOMEN

ATTENTION: USAGE CORRECT

NETTOYAGE

AVERTISSEMENTS POUR UN USAGE CORRECT DE L'APPAREIL

1. La couverture MN-8000 NE DOIT JAMAIS ÊTRE PLIÉE SUR ELLE-MÊME quand elle est en fonctionnement ou quand elle est chaude. **Ne pliez jamais la couverture de sudation et ne mettez jamais de poids en dessus,** qu'elle soit en fonctionnement ou pas, afin d'éviter des interruptions et des dommages irréparables.
2. Durant le fonctionnement, assurez-vous que les panneaux intérieurs du sac soient bien étendus, sans plis. Vérifiez également que la couverture soit bien étendue sur la table, en évitant des piqûres dans le tissu causées par les parties remuantes de la table.
3. Si vous voulez maintenir la couverture tiède et préparée pour le traitement suivant, vous pouvez laisser l'appareil en marche, suivant obligatoirement les instructions suivantes:
    1. Assurez-vous que la MN-8000 est bien étendue sur la surface de la table. Elle ne peut pas être pliée d'aucune forme.
    2. Assurez-vous que la température des trois zones est programmée sur le niveau minimum (Niveau 1, seulement un curseur programmé ▶): regardez *"Fonctionnement: Programmation du niveau de puissance"*.

Avant de commencer n'importe quelle action de nettoyage ou de maintenance, mettez le contrôle de température à zéro et déconnectez l'appareil du réseau d'électricité général.

Afin de garantir un maximum d'efficacité et de durabilité de votre couverture sauna, il est nécessaire d'observer un maximum de prudence à l'heure de la nettoyer. Utilisez un chiffon mouillé d'alcool dilué afin d'éviter les tâches. N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENTS OU DE PRODUITS CHIMIQUES.

Nous suggérons d'envelopper la cliente avec une couverture en plastique jetable avant de commencer le traitement. Cette mesure garantit un maximum d'hygiène et prolongera la durée de vie de votre MN-8000.

ATTENTION: INFORMATION IMPORTANTE

•Cet appareil doit être utilisé exclusivement comme couverture sauna professionnelle. N'importe quel autre usage est inapproprié et, par conséquence, dangereux. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable de possibles dommages soufferts par des personnes, des animaux ou des objets dérivés d'un usage inapproprié, erroné ou irrationnel.

•N'ouvrez pas l'appareil ou ses accessoires. Pour des réparations éventuelles, adressez-vous au service technique. Ne pas respecter cette instruction peut compromettre la sécurité de l'appareil.

•N'utilisez pas la MN-8000 pour des personnes malades, insensibles à la chaleur ou pour des enfants.

•Le chauffage de l'unité de travail se doit à la dissipation thermique naturelle des composants. Évitez des positionnements qui empêchent la ventilation correcte de l'appareil.

•Ne touchez jamais l'unité de travail, ni les prises de courant avec des mains mouillées.

•Ne tirez pas le câble du réseau pour déconnecter l'appareil de la prise de courant.

•N'exposez jamais l'appareil à des conditions environnementales extrêmes (pluie, soleil,..)

•N'introduisez pas d'objets aigus dans la couverture, comme des aiguilles, des limes, etc...

•Retirez toujours le câble de connection électrique de la prise de courant avant d'assembler, nettoyer ou réparer l'appareil.

•Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau. Dans le cas où un liquide pénètre accidentellement dans l'appareil, ne le mettez pas en marche et contactez immédiatement le service technique.

•Il est défendu d'enlever l'étiquette située sur la caisse et sur laquelle se trouve le numéro de série. Le non respect de cette instruction annulera automatiquement la garantie.

•A la fin de la journée, assurez-vous que l'appareil est bien éteint (OFF) et que le câble de réseau est déconnecté du réseau électrique.

•Tenir compte que la perception de chaleur peut varier en fonction des constants CORPORELS et que par conséquence il possible que la perception de chaleur diffère selon la saison.

•Nous recommandons l'utilisation d'un régulateur de voltage afin d'assurer une transmission de courant correcte.

REMPLACEMENT DES SOUS-SECTIONS AMOVIBLES

Dans le cas de remplacement des sous-sections amovibles de la MN-8000, nous vous détaillons ci dessous la procédure à suivre:

1. Eteignez la MN-8000, en mettant les commutateurs à zéro.
2. Déconnectez les trois prises d'alimentation de courant.
3. Étendez la MN-8000 sur une surface plane, comme indiqué sur la Figure 2.

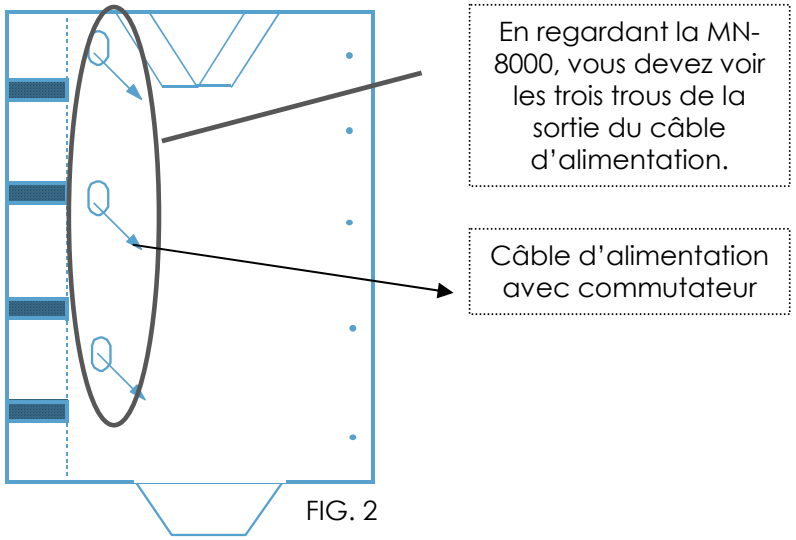
En regardant la MN-8000, vous devez voir les trois trous de la sortie du câble d'alimentation.
Câble d'alimentation avec commutateur

FIG. 2

5. Glissez le câble d'alimentation de la sous-section défectueuse à l'intérieur du sac à travers la fente.
6. Retirez la sous-section chauffante à remplacer. Figure 3.

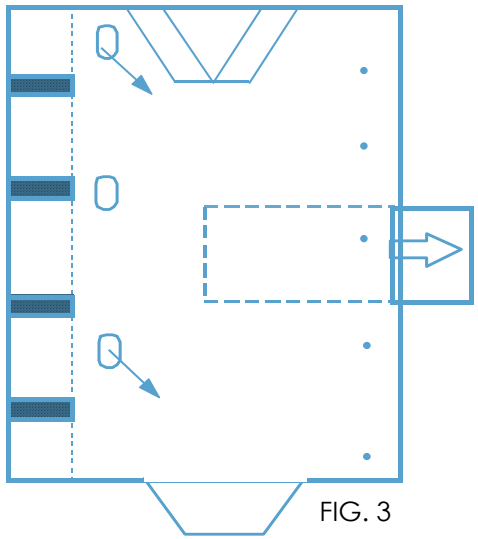

FIG. 3

REMPLACEMENT DES SOUS-SECTIONS AMOVIBLES

7. Prenez la nouvelle sous-section chauffante et positionnez-la comme indiqué sur la Figure 4. (Quand vous regardez la couverture, vous devez voir la sortie du câble d'alimentation et les étiquettes).

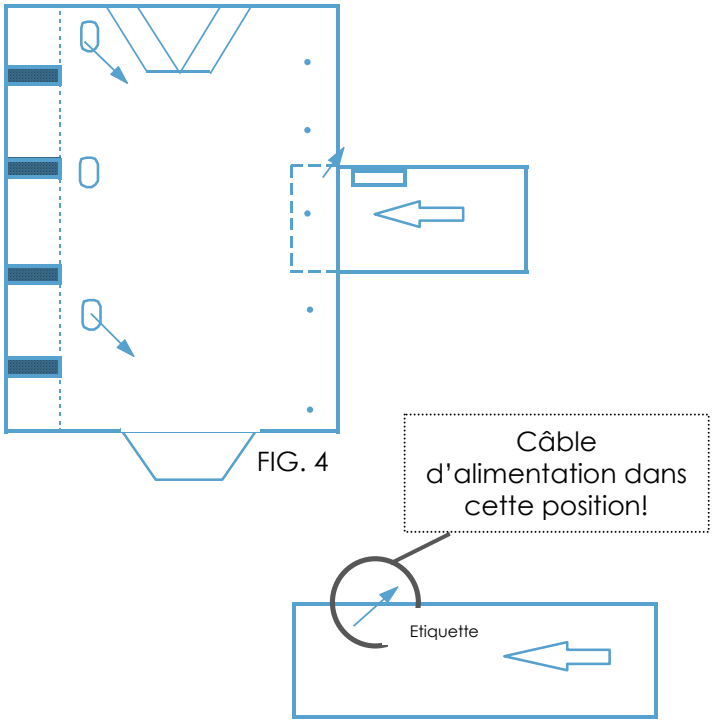

FIG. 4

8. Insérez la sous-section, de façon que le câble d'alimentation sorte de la fente. IMPORTANT: ASSUREZ-VOUS QUE LA SOUS-SECTION À L'INTÉRIEUR DU SAC EST BIEN ÉTENDUE. ELLE NE DOIT JAMAIS ÊTRE PLIÉE.

9. Fermez la fente avec le bouton correspondant et tournez la MN-8000 afin de pouvoir l'utiliser.

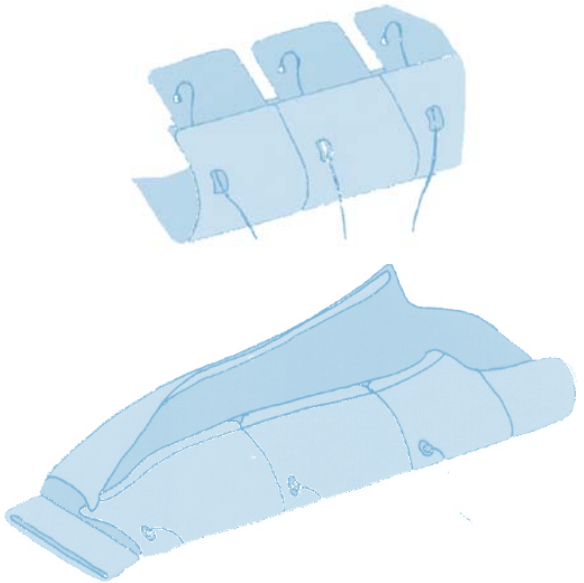

GARANTIE

La **garantie** est valable pour une période de deux années à partir de la date d'achat et s'applique sur le produit et tous ses composants. La date d'achat indiquée sur la facture vaut comme date de commencement.

La garantie couvre la réparation gratuite de toutes les parties endommagées ou des défauts existants avant la date d'achat de la couverture sauna.

La garantie ne couvre pas:

- Irrégularité de fonctionnement ou défauts dérivés d'une installation électrique incorrecte.
- Détérioration ou dommages produits par une installation différente de celle indiquée dans le présent manuel d'instructions.
- Défauts dérivés du fait que le produit a été utilisé avec ou connecté à des accessoires différents de ceux fournis par le fabricant ensemble avec le produit ou ceux formellement autorisés.
- Des vols, des chutes, des conditions thermiques et environnementales extrêmes.
- Des modifications, des connections, ouvertures ou réparations effectuées par du personnel non autorisé.
- Usure naturelle à cause de l'usage du produit.
- Les appareils ayant un numéro de série enlevé, illisible, maltraité, effacé ou modifié.
- Dégâts de transport.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages apportés à des objets ou à des personnes, suite au non respect des avertissements et des instructions détaillés dans ce manuel.

Changements possibles: aucune modification ne peut être faite sans autorisation préalable du fabricant. A la réception d'un appareil endommagé, le produit sera révisé avant d'accepter l'application de la garantie. La marchandise doit être envoyée en franc port.

La garantie est valable si le produit est accompagné du présent document, dûment signé et rempli par l'entreprise de distribution et d'un document fiscal accréditant la date d'achat.

Dans le cas où il se produit un différend quelconque, l'autorité judiciaire espagnole aura la compétence exclusive.

Acheteur		**Cachet du vendeur**
Date d'achat	**N° de série**	

DECLARATION DE CONFORMITÉ

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITÉ
89/336/CEE
73/23/CEE

Electroestética &

MARZO 2005
MARCH 2005
MARS 2005

Nombre del Fabricante: *BIOINSIDE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA, S.L.*
Manufacturer's name:
Nom du fabricant :

Dirección del Fabricante:
Manufacturer's address: *Sant Martí de l´Erm, 22*
Adresse du fabricant : *E 08970 – Sant Joan Despí*
BARCELONA - SPAIN

Declara que el producto: Electrocosmético
Declares that the product: ***Electrocosmetic***
Déclare que le produit : Electro-cosmétique

Nombre del producto: MN 8000
Name of the product:
Nom du produit :

Marca: EMA
Brand:
Marque :

Cumple con la normativa:
Complies with the norm:
Est conforme à la norme :

EN 55014 (1994)
EN 55104 (1995)
EN 61000-3-2 (1995)
EN 61000-3-3 (1995)
CEI 62-39 (1992)

Y por lo tanto responde a los requisitos esenciales de la Directiva:
And therefore cumplies with the essencial requirements of the Directive:
Et ce pour quoi accomplit les conditions essentiels de la Directive:

DIRECTIVA 89/336/CEE (Compatibilidad Electromagnética)
DIRECTIVA 73/23/CEE (Baja tensión – Seguridad eléctrica)

Suggestion du fabricant:

Votre opinion est importante. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, afin que nous puissions vous offrir un meilleur service. Vous pouvez nous contacter en envoyant vos lettres à l'adresse suivante:

Bioinside Investigación y Tecnología, S.L. U
Sant Martí de l´Erm, 22
Polígono Industrial Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona
España

Tel. National: 93 444 42 62
Tel. International: + 34 93 477 42 63
Courrier électronique: ema@ema.es

INFORMEZ-VOUS DE NOS NOUVEAUTÉS

NOUS SOMMES AU SERVICE DE NOS CLIENTS ET NOUS ESSAIERONS TOUJOURS DE VOUS AIDER

1. SI VOUS AVEZ DES DOUTES OU DES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS, AUSSI BIEN AU NIVEAU TECHNIQUE CONCERNANT L'USAGE DE L'APPAREIL ESTHÉTIQUE, QUE POUR DES QUESTIONS CONCERNANT LA RÉALISATION DE TRAITEMENTS.
2. NOUS OFFRONS DES FORMATIONS AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE ET NOUS POUVONS VOUS AIDER À AUGMENTER VOS CONNAISSANCES ET À AMPLIFIER VOTRE MAÎTRISE DES TECHNIQUES DE TRAITEMENT. INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE CALENDRIER DE FORMATION.

EMA

Bioinside Investigación y Tecnología, S.L.U
Polígono Industrial Fontsanta
Sant Martí de l´Erm, 22
08970 Sant Joan Despí
Barcelona (España)

Tel. +34 902.31.51.71
ema@ema.es